


LABORATORIO: BASCULAS PROMETALICOS S.A.
Laboratory
INSTRUMENTO: BÁSCULA CAMIONERA
Apparatus
FABRICANTE: METLER TOLEDO
Manufacturer
MODELO DEL INSTRUMENTO: JAGXTREME
Instrument Model
IDENTIFICACION: 5317382 – 5KD **CODIGO INTERNO:** N.I.
Identification number Internal cod
INTERVALO DE MEDICION: 200 kg 80000 kg
Weighing range
SOLICITANTE: UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA
Customer
DIRECCION SOLICITANTE: Km 17 + 150 VÍA YUMBO – MEDIA CANOA
customer address
SITIO DE CALIBRACION: BASCULA SUR MEDIA CANOA, 552
calibration adress
CIUDAD: YOTOCO **DEPARTAMENTO:** VALLE DEL CAUCA
City Department
FECHA DE RECEPCION: 2017 07 15
date of calibration
FECHA DE CALIBRACION: 2017 07 15
date of calibration
NUMERO DE PAGINAS DE CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 3
Number or pages of this certificate and documents
FECHA DE EMISIÓN: 2017 07 19
Date of issue
FIRMAS AUTORIZADAS:
Authorized signatures


WILSON J. PAZ VALENCIA

METROLOGO
Calibrado por - Calibrate by


MARCELA MEZA MONTES

JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGIA
Revisado por - checked by

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se halla obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate (report) is an accurate record of the performed measurement results. This certificate must not be partially reproduced, permission of the issuing laboratory. The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for any ensuing damages due to the misuse of the calibrated instruments.

LPS-R-10/V9

12 de jun de 17

1- INSTRUMENTO:

RANGO DE PESAJE: 200 kg - 80000 kg

RANGO DE MEDICION:

C_{max}' 51360 kg

C_{min}' 2000 kg

MINIMA DIVISION (d): 10 kg

TOLERANCIA ACORDADA: 30 kg

N°CERTIFICADO: 18393

Number

2-PROCEDIMIENTO :

Las pruebas que se aplican siguen lo establecido en la GUIA SIM (MWG7) , 2009. A continuación se detallan cada una de ellas:
REPETIBILIDAD: Consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo carga y del instrumento. ERRORES DE LAS INDICACIONES: Consiste en aplicar diferentes cargas distribuidas sobre el alcance de medición para estimar el desempeño del instrumento. EXCENTRICIDAD: Consiste en poner una carga de prueba en diferentes posiciones del receptor de carga de tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe diferentes posiciones

Metodo de calibración: SUSTITUCION DE CARGA

3- RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:

REPETIBILIDAD:

PRUEBA REPETIBILIDAD		unidad
CARGA	51370	kg
REPETICION	INDICACION	
1	51370	
2	51370	
3	51370	
4	51370	
5	51360	
6	51370	
7	51370	
8	51370	
9	51370	
10	51370	
Desviación estandar carga	3	


EXCENTRICIDAD:

PRUEBA EXCENTRICIDAD				unidad
POSICION	CARGA	17040		kg
	INDICACION	DIFERENCIA	INDICACION EN CERO	DIFERENCIA
1	17040	0	0	0
2	17050	10	0	0
3	17050	10	0	0
4	17040	0	0	0
5	17040	0	0	0
	Δecc _i max	10		0

ERRORES DE INDICACIÓN:

PRUEBA EXACTITUD DE ERRORES			unidad	kg
CARGA	INDICACION 1	ERROR 1	INDICACION 2	ERROR 2
0	0	0	0	0
2000	2000	0	2000	0
14000	14000	0	14000	0
28000	28000	0	28000	0
38940	38940	0	38940	0
51360	51370	10	51370	10


UBICACIÓN DE LAS CARGAS DE ACUERDO AL TIPO DE INSTRUMENTO



Portátil e industrial



Sistemas especiales



Camionera

LPS-R-10/V9
12 de jun de 17

Página **3 de 3**
N°CERTIFICADO: **18393**
Number

4-TRAZABILIDAD:

El laboratorio de metrología en masa y balanzas de BASCULAS PROMETALICOS S.A asegura la trazabilidad de los patrones usados en estas mediciones, con los patrones nacionales de referencia y calibrados por el INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.

5-IDENTIFICACION DE PATRONES:

CODIGO	N°CERTIFICADO	FECHA CALIBRACION	LABORATORIO EMISOR
401-08	CMP 0896	2016 11 19	METROGLOBAL
401-09	CMP 0898	2016 11 19	METROGLOBAL
301-05	CMP 0897	2016 11 19	METROGLOBAL


6-CONDICIONES AMBIENTALES:

	Inicial	Final
Temperatura °C	26,9	29,9
Humedad Relativa %	58	49

7- GRÁFICOS DE CALIBRACIÓN:

Carga	Error 1 (+/-)	Error 2 (+/-)	Unidad
0	0	0	kg
2000	0	0	kg
14000	0	0	kg
28000	0	0	kg
38940	0	0	kg
51360	10	10	kg

CARGA - ERROR kg

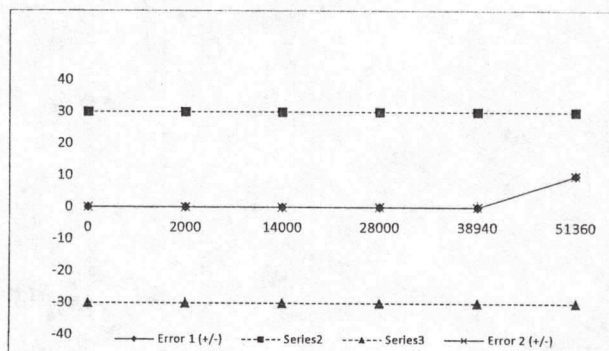

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ y con una probabilidad de cobertura del 95%. La incertidumbre se estima de acuerdo al instructivo LPS-I-09

U (E)	8,6E+00	kg	+	6,3E-04	W
-------	---------	----	---	---------	---

La carga W debe estar en kg

LPS-R-10/V9
12 de jun de 17

FIN DEL CERTIFICADO.

ANEXO

N°1

ANEXO CERTIFICADO 18393

ERRORES DE INDICACIÓN POR MODULO:

OBS	CARGA	INDICACION 1	ERROR 1	INDICACION 2	ERROR 2
MODULO C	2000	2000	0	2000	0,000
	6000	6000	0	6000	0,000
	10000	10000	0	10000	0,000
	16000	15990	-10	16000	0,000
	20000	20000	0	20000	0,000

OBS	CARGA	INDICACION 1	ERROR 1	INDICACION 2	ERROR 2
MODULO B	2000	2000	0	2000	0,000
	6000	6000	0	6000	0,000
	10000	10000	0	10000	0,000
	16000	16000	0	16000	0,000
	20000	20000	0	20000	0,000

OBS	CARGA	INDICACION 1	ERROR 1	INDICACION 2	ERROR 2
MODULO A	2000	2000	0	2000	0,000
	6000	6010	10	6000	0,000
	10000	10010	10	10010	10,000
	16000	16000	0	16000	0,000
	20000	20000	0	20000	0,000