

Laboratorio: BASCULAS PROMETALICOS S.A.
Laboratory: N° Certificado: 20947
Instrumento: CAMIONERA
Apparatus: Number:
Fabricante: PROMETALICOS
Manufacturer:
Modelo del Instrumento: 100870 FED
Instrument Model
Identificación: T174302622 **Código Interno:** N.I
Identification number: Internal cod:
Intervalo de Medición: 200 kg - 100000 kg
Weighing range
Solicitante: CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S
Customer:
Dirección del Solicitante: km 9 + 200 VIA GIRARDOT NARIÑO
Customer address:
Sitio de Calibración: BÁSCULA 1
Calibration adress:
Ciudad: GIRARDOT **Departamento:** CUNDINAMARCA
City: Department:
Fecha de Recepción: 2019 06 21
Reception date:
Fecha de Calibración: 2019 06 21
Date of calibration:
Numero de paginas de certificado, incluyendo anexos: 4
Number or pages of this certificate and documents:
Fecha de Emisión: 2019 07 12
Date of issue:
Calibrado por: Edwin Yonett Osorio Bañol.
Calibrated by:
FIRMAS AUTORIZADAS:
Authorized signatures

Wilmar Iván Corredor
Jefe Laboratorio de Metrología
Revisado por - checked by

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se halla obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate (report) is an accurate record of the performed measurement results. This certificate must not be partially reproduced, permission of the issuing laboratory. The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for any ensuing damages due to the misuse of the calibrated instruments.

LAB R-18/V10
26-mar.-19

1 - Instrumento:

Rango de Pesaje: 200 kg - 100000 kg

Rango de Medición:

Cmax' 67770 kg

Cmin' 2000 kg

División de Escala Real (d): 10 kg

Tolerancia Acordada: 30 kg

N° Certificado: 20947

Number:

2 - Resultados de la Medición, antes del ajuste:

Debido a que el instrumento ha sido ajustado antes de la calibración, a continuación se reportan los resultados obtenidos antes de iniciar la calibración del instrumento:

Valores del Excentricidad				Unidad
Posición	Carga	34590		kg
	Indicación	Diferencia	Indicación en Cero	Diferencia
1	34590	0	0	0
2	34580	10	0	0
3	34590	0	0	0
4	34600	10	0	0
5	34590	0	0	0
6	34590	0	0	0
7	34590	0	0	0
8	34580	10	0	0
Δlecc,i max		10	Δlecc,i max	0

Error identificado para una carga ≥ al 50 % de la carga máxima operacional		
Carga	Indicación	Error
34590	34590	0

Repetibilidad		
1	2	3
34590	34590	34590
Desviación Estandar	0	

Carga de Ajuste 10000 kg

Pesas patrón 10000 kg

Peso Conocido -

LAB-R-18/V10
26-mar.-19

3 - Procedimiento:

Las pruebas que se aplican siguen lo establecido en la GUIA SIM (MWG7) , 2009. A continuación se detallan cada una de ellas:
Repetibilidad: Consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo carga y del instrumento. **Errores de Indicaciones:** Consiste en aplicar diferentes cargas distribuidas sobre el alcance de medición para estimar el desempeño del instrumento. **Excentricidad:** Consiste en poner una carga de prueba en diferentes posiciones del receptor de carga de tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe diferentes posiciones

Metodo de calibración: Sustitución de Carga

4 - Resultados de la Calibración:

Repetibilidad:

Prueba de Repetibilidad		Unidad
Carga	67770	kg
N° Repeticiones	Indicación	
1	67780	
2	67780	
3	67790	
4	67790	
5	67790	
6	67790	
7	67790	
8	67790	
9	67790	
10	67780	
Desviación Estandar	5	

Excentricidad:

Prueba de Excentricidad				Unidad
Posición	Carga	34590		kg
	Indicación	Diferencia	Indicación de Cero	Diferencia
1	34590	0	0	0
2	34580	10	0	0
3	34580	10	0	0
4	34590	0	0	0
5	34580	10	0	0
6	34590	0	0	0
7	34590	0	0	0
8	34580	10	0	0
Δlecc,i max		10	Δlecc,i max	0

Errores de Indicación:

Prueba Exactitud de Errores			Unidad	kg
Carga	Indicación 1	Error 1	Indicación 2	Error 2
0	0	0	0	0
2000	2000	0	2000	0
14000	14000	0	14000	0
29190	29190	0	29190	0
48580	48580	0	48580	0
67770	67780	10	67790	20

Ubicación de las cargas de acuerdo al tipo de instrumento.



Portátil e Industrial



Sistemas Especiales



LAB-R-18/V10
26-mar. 19

Página 4 de 4
N° Certificado: 20947
Number:

5 - Trazabilidad:

El laboratorio de metrología en masa y balanzas de Basculas Prometalicos S.A asegura la trazabilidad de los patrones usados en estas mediciones, con los patrones nacionales de referencia y calibrados por el Instituto Nacional de Metrología.

6 - Identificación de Patrones:


Codigo	N° Certificado	Fecha de Calibración	Laboratorio Emisor
401-08	LMS 15872	2019 06 10	SIGMA

7 - Condiciones Ambientales:

Condiciones Ambientales	Inicial	Final
Temperatura (°C)	28,1	27,1
Humedad Relativa (%)	62	65
Presión Atmosférica (hPa)	790,0	790,0

8 - Gráficos de Calibración:

Carga	Error 1 (+/-)	Error 2 (+/-)	Unidad
0	0	0	kg
2000	0	0	kg
14000	0	0	kg
29190	0	0	kg
48580	0	0	kg
67770	10	20	kg

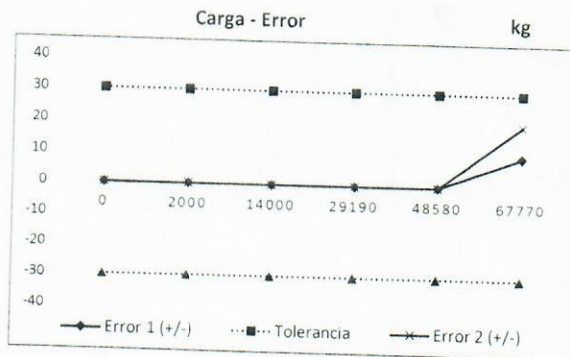

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ y con una probabilidad de cobertura del 95%. La incertidumbre se estima de acuerdo al instructivo LPS - I - 09

U (E)	8,6E+00	kg	+	4,4E-04	W
---------	---------	----	---	---------	---

La carga W debe estar en kg

LAB-R-18/V10
26-mar.-19

FIN DEL CERTIFICADO.